

Examen du 17.12.04

Concerne: [REDACTED]

Diagnostic:

Matériel utilisé: Coussins Roho monovalve et Debbonair Dynamics

Motif de l'examen: Comparaison de coussins


Résultat:

Conclusion:


Recommandations:

*Parapluie complète sur hernie discale D10-D11 apère
 ~ 75 Kg*


Dr méd. A. Al-Khodairy

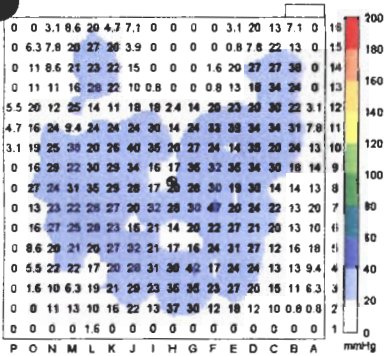


0001 17 Dec 2004 10:13:43.46AM
 roho 32 mbar




Capteurs sollicités 210
 Coefficient de variation 47.5%
 Ecart type 9.5
 Pression moyenne 19.9
 Pression maximum 47
 Centre de pression 8.1, 8.5

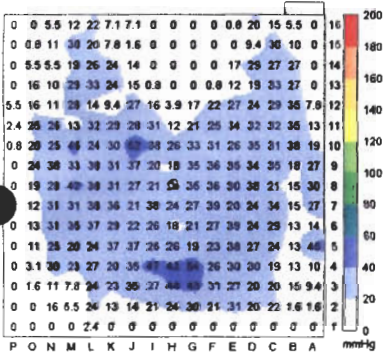


0002 17 Dec 2004 10:14:53.28AM
 roho 50 mbar



Capteurs sollicités 206
 Coefficient de variation 47.8%
 Ecart type 11.2
 Pression moyenne 23.4
 Pression maximum 54
 Centre de pression 8.0, 8.1

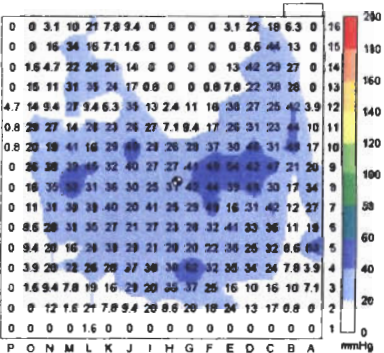


0003 17 Dec 2004 10:15:26.70AM
 Roho 60 mbar




Capteurs sollicités 206
 Coefficient de variation 55.6%
 Ecart type 19.2
 Pression moyenne 23.7
 Pression maximum 59
 Centre de pression 7.8, 8.8


0009 17 Dec 2004 10:27:39.00AM
 Debonnaire 50 mbar

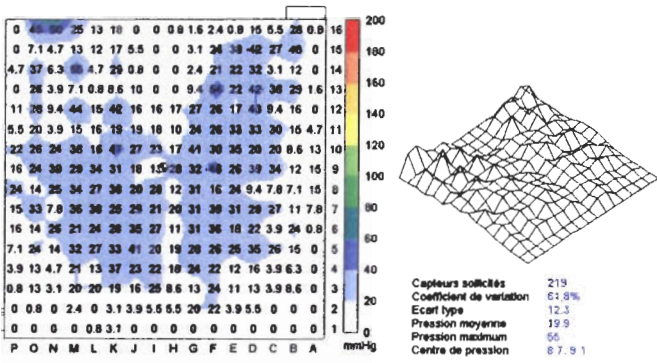


0010 17 Dec 2004 10:29:12.76AM
 Debonnaire 36 mbar

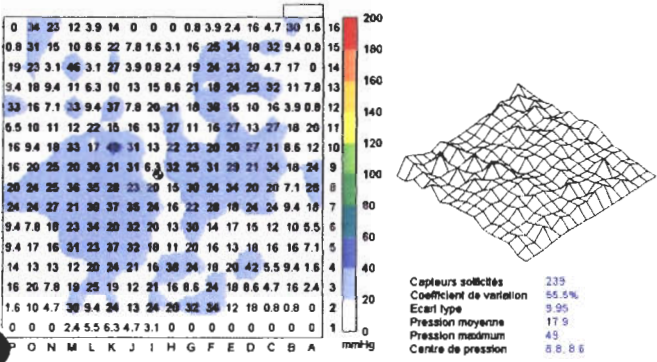


0011 17 Dec 2004 10:30:06.13AM
 Debonnaire dégonflé

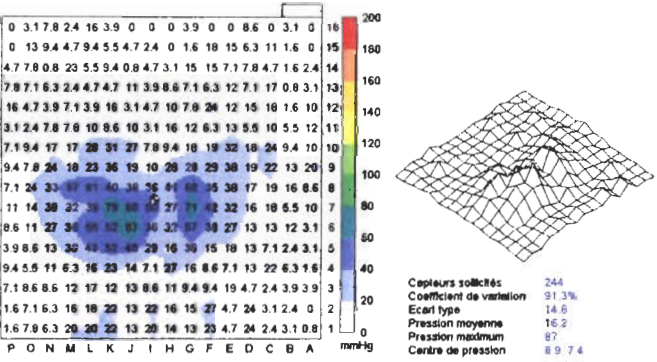


0004 17 Dec 2004 10:17:34.49AM
rho 24 mbar

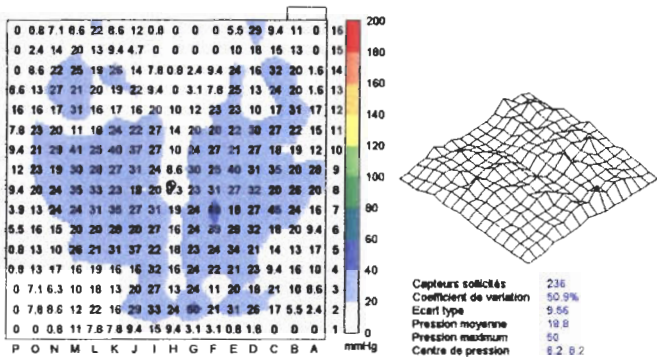


0005 17 Dec 2004 10:18:27.19AM
Roho dégonflé

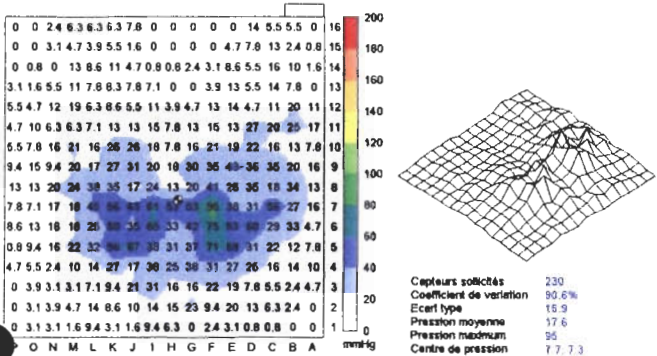

0006 17 Dec 2004 10:22:21.96AM
Debonnaire maximum

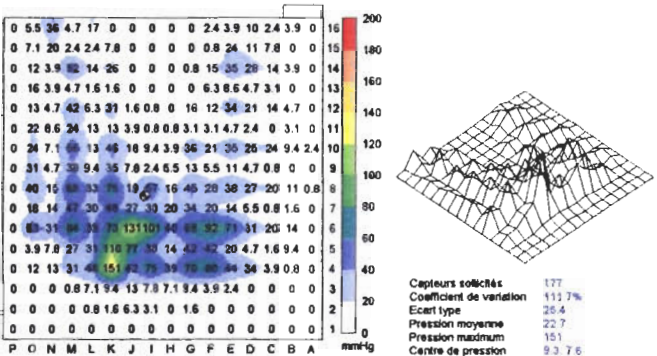

0007 17 Dec 2004 10:25:06.92AM

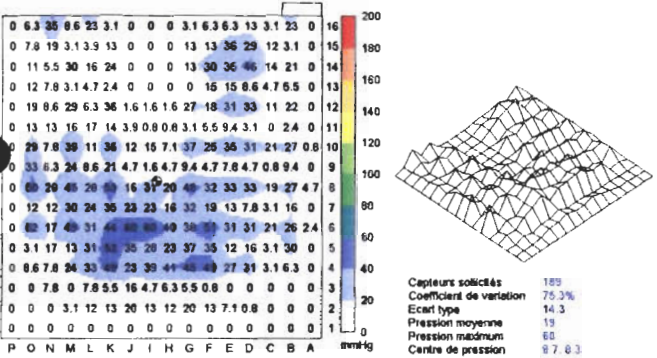

0008 17 Dec 2004 10:26:36.06AM
Debonnaire 60 mbar

